

农学院实验室安全检查通报

2021 年第 5 期

2021 年 6 月 29 日

6 月 28 日，共发现农学院实验室 55 处安全隐患，现将本次检查情况通报如下：

一、 总体情况

6 月 28 日，农学院安全组检查发现的问题主要集中在危化品管理、个人防护等方面，具体如下：


1. 危化品台账记录不完整，账物不符合，易制毒、易制爆登记本在行政楼 A217 领取；
2. 危化品放置不符合规范，如：易燃、易制毒、易制爆药品混放；易制毒、易燃、易制爆的药品使用后，未及时放回危化品柜等；
3. 部分实验室内没有消防设施，灭火器过期要及时更换，灭火器要放在显眼的位置，请自备盛放灭火器的架子；
4. 部分实验室内未专门规划出实验室废弃物存放区，请用黄色胶带规划出相应的区域；
5. 实验室废弃物收集处置不规范，如废液桶、废胶桶未张贴标签；废胶桶未盖等；
6. 废液桶不能叠加放置，下面要有托盘，防止废液外漏等；
7. 试剂存放不符合要求，如：试剂瓶盛放液体未贴上标签，有些试剂瓶上的标签已腐蚀、模糊不清等；
8. 个人防护不规范，如学生做实验时未穿实验服；
9. 特种设备如灭菌锅使用登记不规范；
10. 实验垃圾未进行分类；
11. 实验室内饮食；
12. 药品箱内的药品有些已过期，未及时补充。

请各课题组于 7 月 6 日前完成整改。请将整改后的照片整理成

WORD 文档，发送至邮箱：koujing@njau.edu.cn。

二、部分现场问题照片

理科楼 A101 三氯甲烷放在通风橱内，负责人董慧



理科楼 A107 垃圾太多，没放置在危废专区；空瓶太多，未及时处理，负责人曹爱忠



理科楼 A123 废液桶无二次防漏的架子；危化品台账登记不规范；剂瓶无标签，负责人刘康



易制毒 危险化学品使用登记台账 (使用)

实验室: _____ 实验员: _____ 实验安全负责人: _____

序号	品名	入库		出库		保管员1		保管员2		备注
		数量 (ml/g)	日期	数量 (ml/g)	日期	姓名	姓名	姓名	姓名	
	三氯甲烷									
	三氯甲烷		2019.12.1	500ml	2019.12.1	刘康	刘康	刘康	刘康	
	三氯甲烷			300ml	2019.12.1	刘康	刘康	刘康	刘康	
	三氯甲烷		2019.12.1	200ml	2019.12.1	刘康	刘康	刘康	刘康	



理科楼 A401, A402 灭火器过期；灭菌锅使用未登记；装液体的瓶子无标签，负责人周宝良



理科楼 A418 实验室内饮食，负责人蔡彩平



理科楼 A531 废胶桶未盖，负责人刘玲珑



理科楼 A525 学生未穿工作服负责人，王益华



理科楼 A527 危化品记录不完整，负责人杨冰



理科楼 A515 水池周围太乱；急救箱内药品不全，负责人周时荣



理科楼 A 511 水池周围太乱；试剂瓶无标签 负责人赵志刚




理科楼 A502 超净台内酒精灯燃烧无人看管；实验垃圾未分类，负责人王云龙



理科楼 A503 学生在实验室未穿工作服，负责人张文伟



理科楼 C804 私拉电线、在冰箱内放置小仪器，负责人 华健




理科楼 C803 氯仿放在走廊的冰箱里；仪器上堆放杂物；饮用水放实验室冰箱；试剂标签不明；学生做实验未穿工作服；急救箱内药品未补充， 负责人严远鑫



理科楼 A811 学生做实验未穿工作服，责任人 孔忠新



理科楼 A801 灭菌锅使用未登记，负责人王卓然



理科楼 A826 学生做实验未穿工作服，负责人王超龙



理科楼 A431 危化品和台账不符，负责人郭旺珍




生科楼 B3014-3022 缺少药品明细表；缺少警示线和警示标志；未使用黄色垃圾袋；缺少使用状态标牌，负责人黄梅



耕作制度与农田生态实验室 未穿实验服；垃圾未分类；实验室内饮水；灭火器无外箱或者支架；存放位置环境杂乱；废液桶无标签；缺少药品明细表；实验环境差卫生脏乱， 负责人杨海水





生科楼负 B1021 废液桶无标签、无警示线；垃圾未分类，负责人徐志刚




理科南楼 F532 学生未穿工作服；钥匙在柜子上无人管理；无药品明细，负责人李凯



理科南楼 F534 学生未穿工作服负责人邢光南

理科南楼 F613 废液桶无标签、无警示线；管制危化品与非管制危化品混放
负责人王吴彬

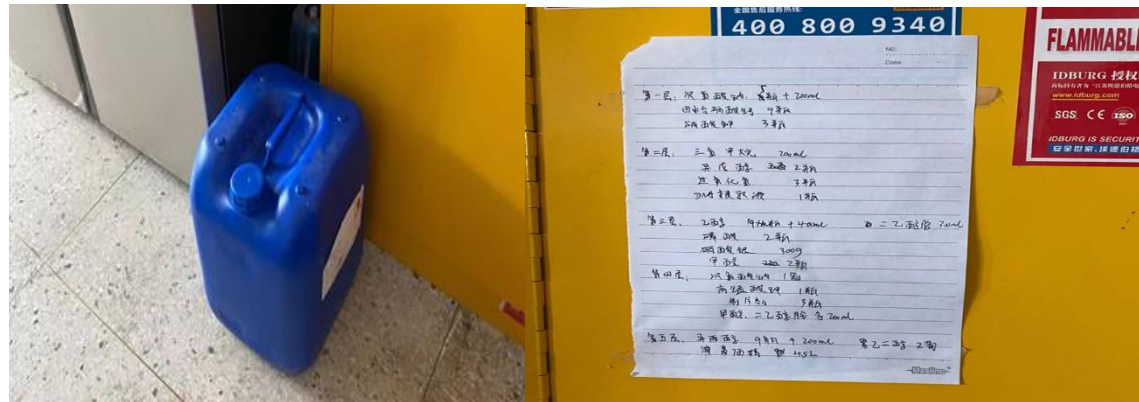

逸夫楼 5038 学生未穿工作服、危化品柜上未张贴无药品明细，负责人朱永和

